


Orientation pour les tests moléculaires au point de service (p. ex., ID NOW^{MC}, GeneXpert[®]*)

- Aucune preuve de SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 détecté
- Test de confirmation requis

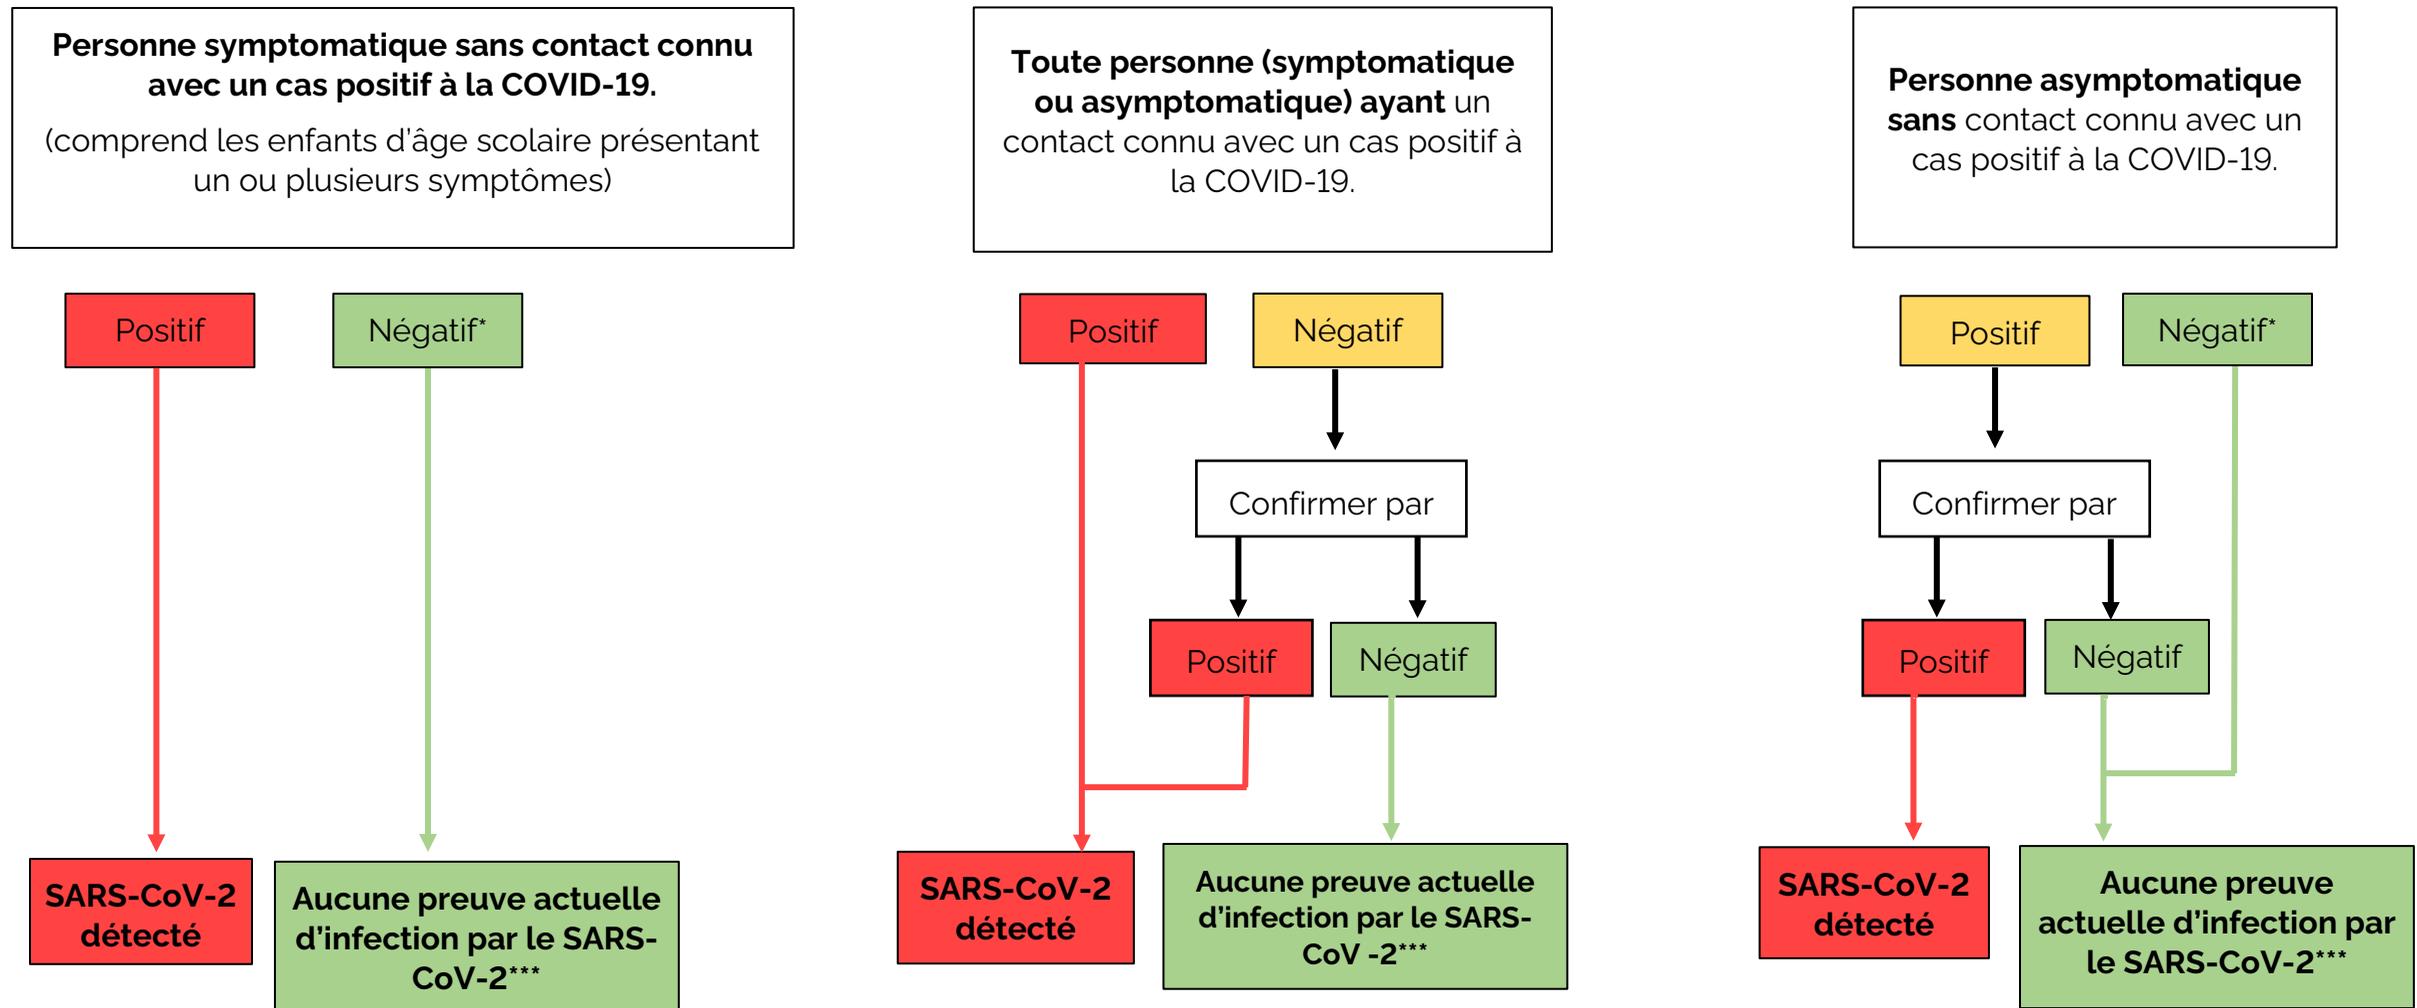


* Il faut tenir compte des antécédents cliniques ou d'exposition, de la prévalence de la maladie dans la collectivité et du risque ou de la vulnérabilité de la population pour déterminer si un test de confirmation est nécessaire dans ces scénarios.

**Lorsque le test GeneXpert est utilisé en tant que test validé dans un laboratoire autorisé, un test de confirmation n'est pas nécessaire.

*** Continuer à respecter les mesures de santé publique et de prévention et contrôle des infections.

Orientation pour les tests antigéniques au point de service (p. ex., Panbio^{MC}, BD Veritor^{MC}) et orientation pour l'autodépistage (p. ex., Lucira^{MC})

- Aucune preuve de SARS-CoV-2
- SARS-CoV-2 détecté
- Test de confirmation requis

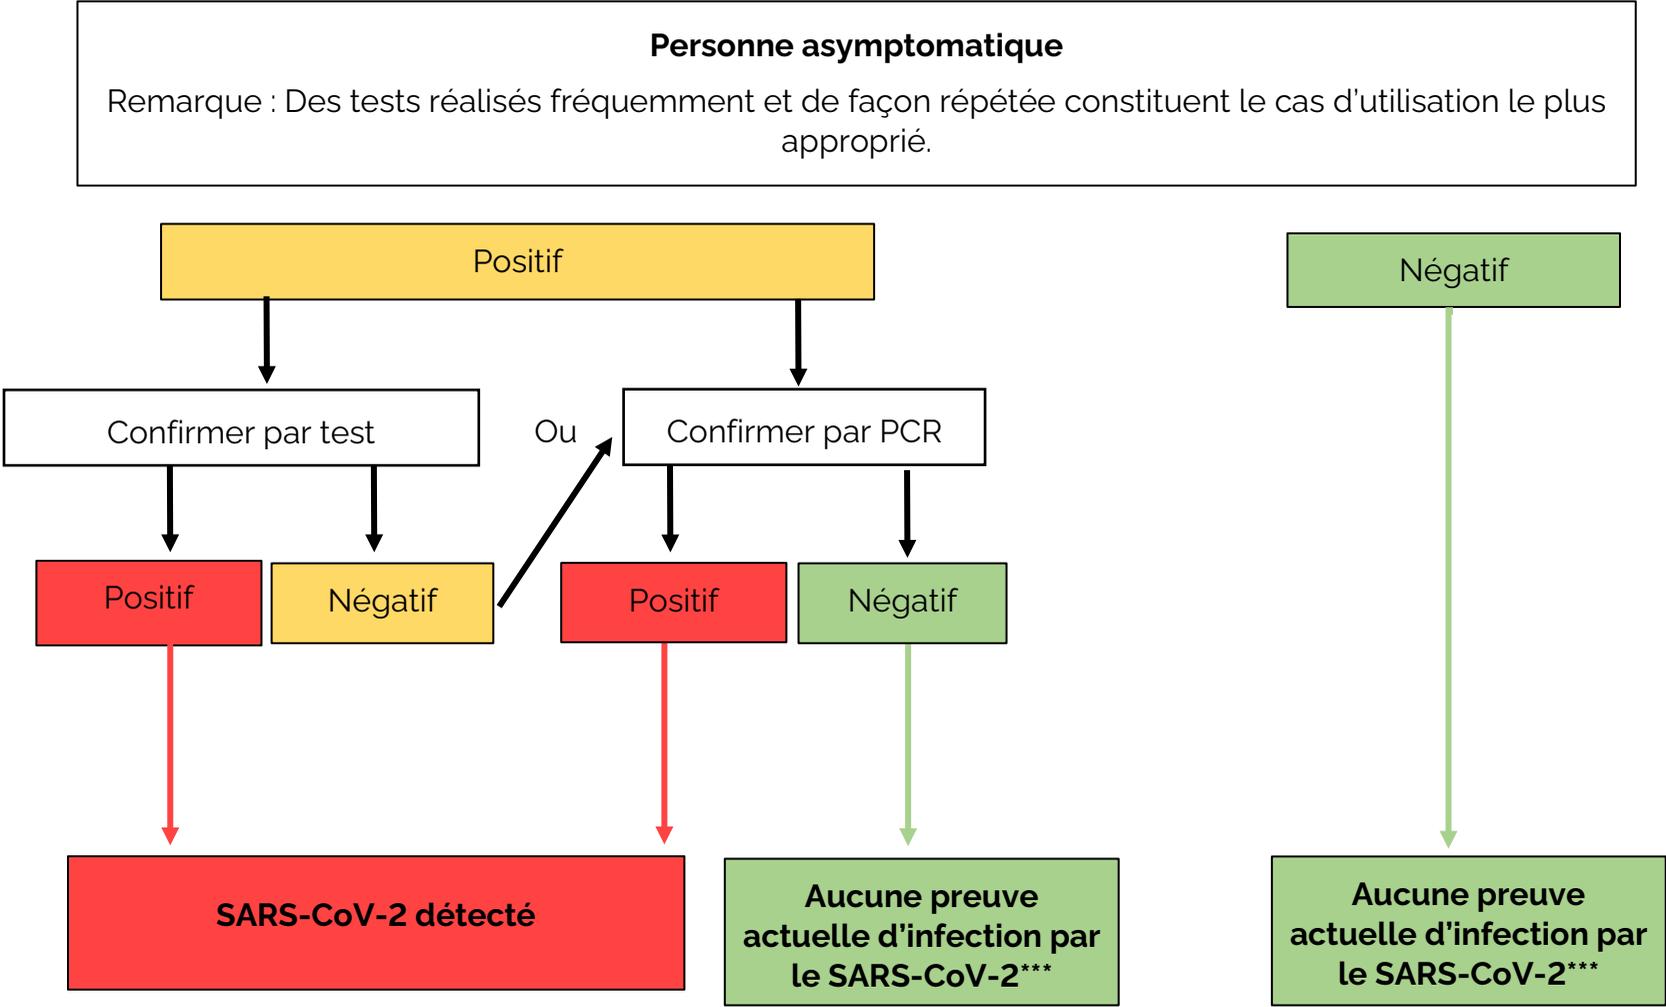

*** Continuer à respecter les mesures de santé publique et de prévention et contrôle des infections.